

株式会社ニチオン



●代表者メッセージ

消毒と滅菌の前には、効果的で安全な、細心の注意を払った洗浄を行っておくことが常に重要です。

PRポイント

- 熟練職人による手術器械の製造技術（複雑機構、特注形状）
- 手術器械の洗浄プロセスをハード・ソフトの両面からサポート
- 国際標準をリードする欧州の洗剤・洗浄機メーカーとの連携

製品・サービス

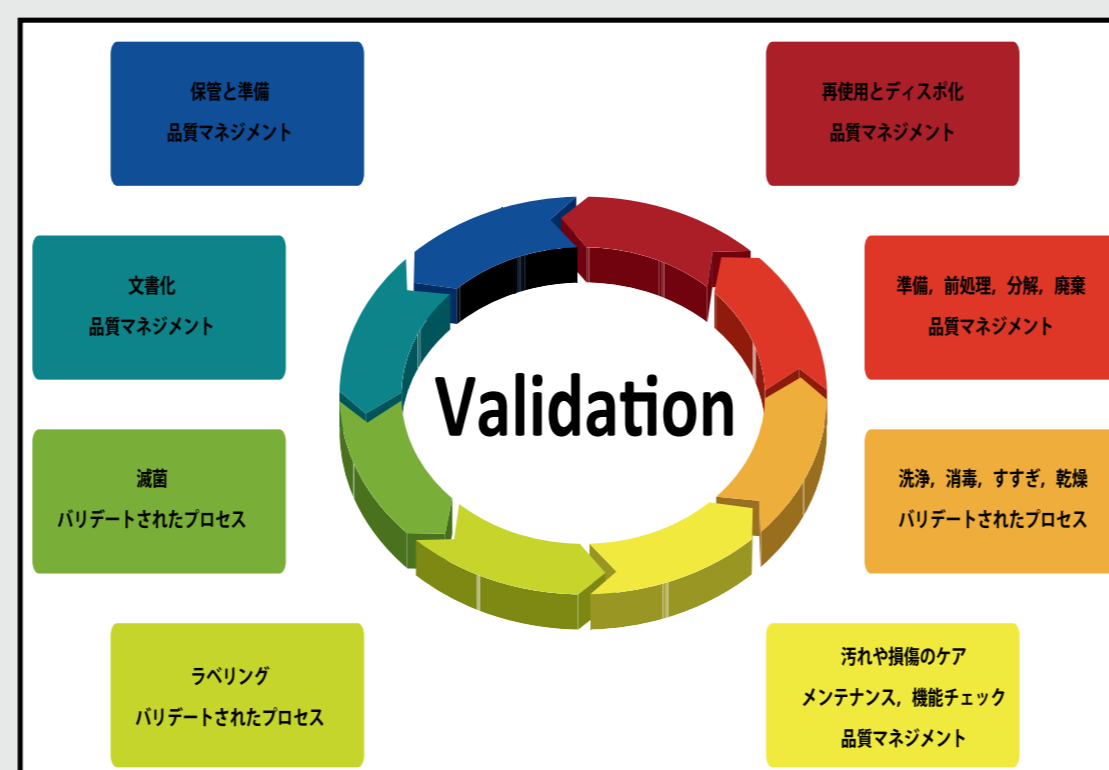
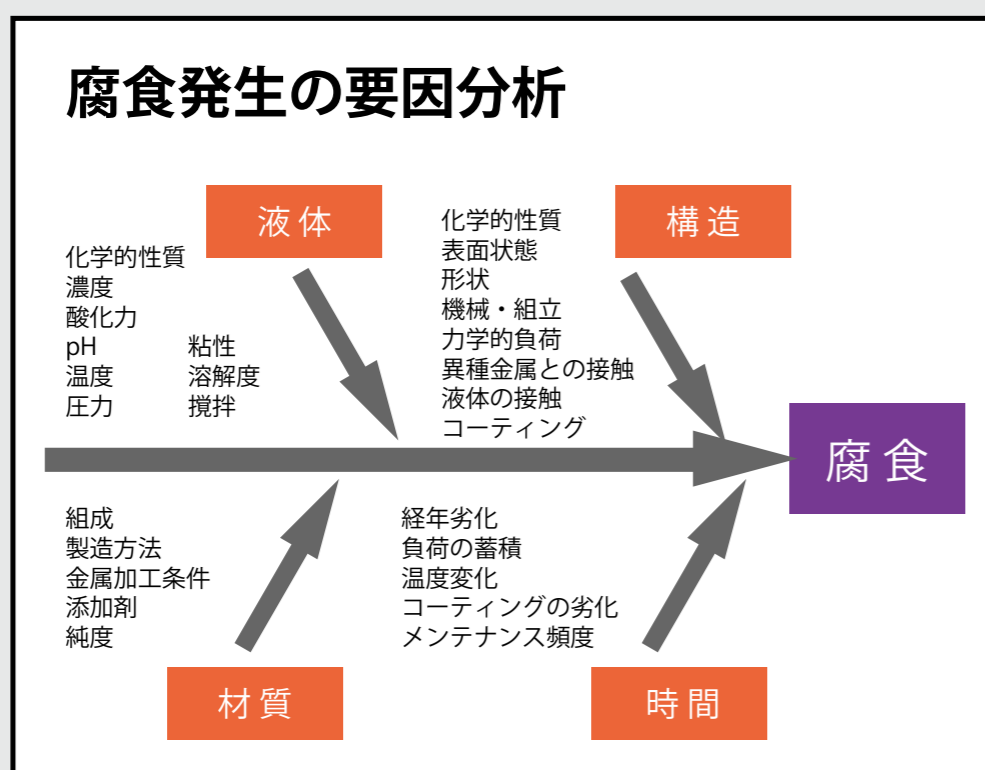


洗浄後の残留タンパク質は下記要因に依存

- ・手術中の使用状況
- ・洗浄プロトコール
- ・洗浄までの経過時間
- ・用手作業の品質
- ・洗浄装置の性能
- ・夾雑物の影響
- ・検証技術



Parameter: 20910.20V (FOAM ACTV) bei 25°C ohne Enzym 1, 12.01.2017						
(Bilder der ungespülten Muster)						
Produkt	0 min. Original	15 min.	30 min.	60 min.	Gespült	Datum:
20910.20V						12.01.2017
100%						
Bei 25°C						
klar						

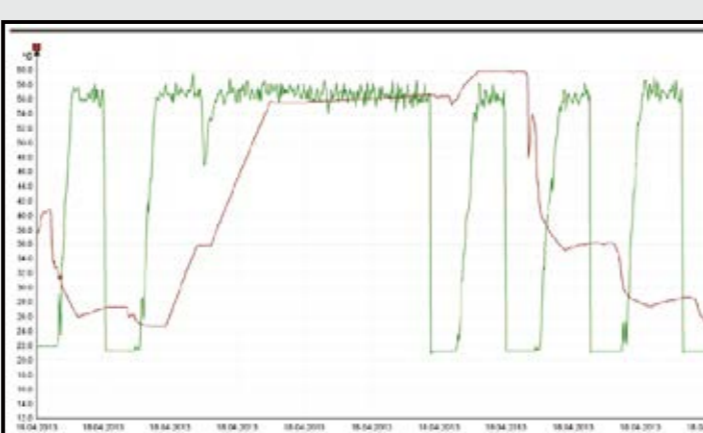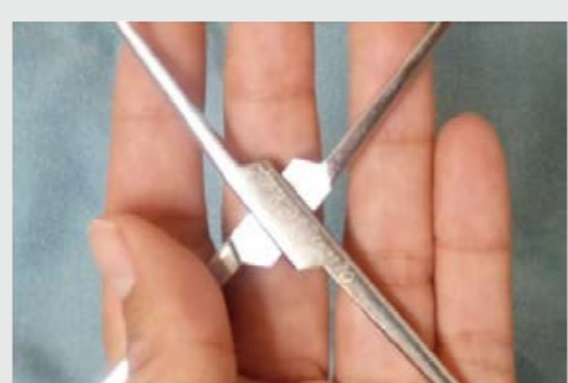

所在地	千葉県船橋市栄町 2-12-4
連絡先	TEL 047-431-1871 E-mail info@niton.co.jp
HPアドレス	http://niton.jp
設立	1911年4月
資本金	12,000,000円
代表者	本田 宏志
経営理念	ひとのやらないこと、ひとにやれないこと、やれない領域にどんどん挑戦する。医療技術が高度化し、ヘルスケアニーズが多様化する時代において、未来を担う技術開発と、最適な医療の普及を目指して医療の価値を追求し続ける。
業種分野	医療機器製造販売業

事業内容

診療器具、手術器械、医療機器、医療材料、医薬品、感染防止機器・器具、病院設備機器の製造・輸入・販売、革新的な医療器械・材料の開発企画、ヘルスケアリスクマネジメントに関わるコンサルティング